质保检验和维护信息

College Park 建议按照以下质保检验计划安排病人进行假足检查。

病人体重和/或冲击力较大时可能需要更频繁的检查。我们建议每次进行质保检验时，目视检查以下适用零件是否存在过度磨损和疲劳。

- 复合体和连接件
- 脚壳

ACCENT 质保检验计划：每年检查一次。

技术协助/紧急服务（24-7-365 全天候）

College Park 正常工作时间为周一至周五 8:30 AM – 5:30 PM（美国东部标准时间）。在此时间之外，您可以拨打紧急技术服务电话，联系 College Park 销售代表。

college park

800.728.7950 | 586.294.7950 | college-park.com

美国制造
185 CHI INS AC TIS 170227

COLLEGE PARK INDUSTRIES
27955 College Park Dr.
Warren, MI 48088 USA

EC REP **EMERGO 欧洲**
Prinsessegracht 20, 2514 AP
The Hague, Netherlands

澳大利亚赞助商
EMERGO 澳大利亚
Level 20, Tower II
Darling Park
201 Sussex Street
Sydney, NSW 2000
Australia

©2017 College Park Industries, Inc.保留所有权利。College Park 和 Accent 是 College Park Industries 公司的注册商标。美国专利号 7,862,622.

技术说明书

accent®

产品特点：

- 可调脚跟
- 窄/宽选项
- 超级美观

包装内容(IP)	包装内容(DP)
(1) 只 Accent 假足（配备粘合脚壳）	(1) 只 Accent 假足（配备粘合脚壳）
(1) 个护踝罩	(1) 个护踝罩
(1) 支 CA 粘合剂	(1) 个套筒接头
	(1) 个塔架连接件（4 孔，外螺纹或内螺纹）
	(1) 个DP 切割夹具
	(1) 支 CA 粘合剂

college park
technology for the human race

假足构件

下图帮助您熟悉 Accent 的独特零件。这些零件在说明书中进行了引用说明，用于组装假足或在寻求技术服务时参考。

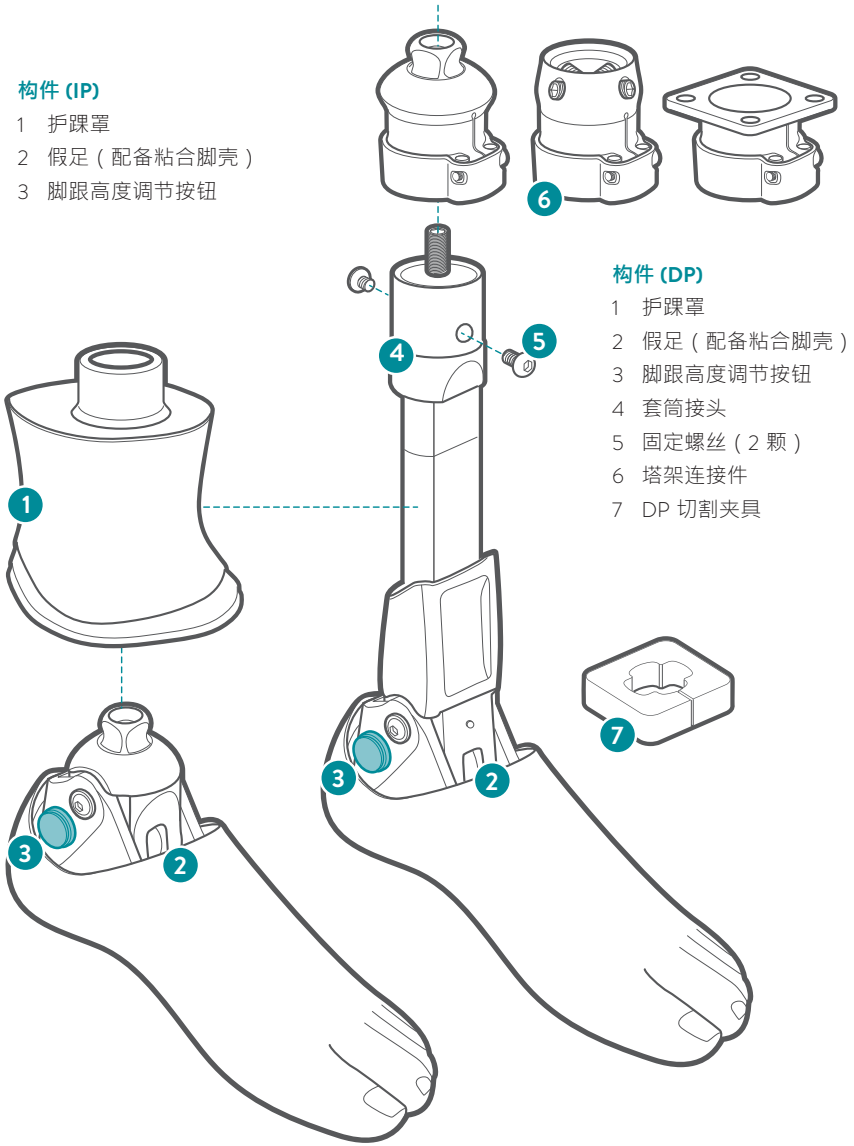

构件 (IP)

1 护踝罩
2 假足（配备粘合脚壳）
3 脚跟高度调节按钮

构件 (DP)

1 护踝罩
2 假足（配备粘合脚壳）
3 脚跟高度调节按钮
4 套筒接头
5 固定螺丝（2 颗）
6 塔架连接件
7 DP 切割夹具

警告

- 请勿使本品接触极端 pH 环境或腐蚀物质（水、盐水或其他液体）。
- 若不遵守该技术说明书或在有限质保范围之外使用本品，可能会对病人构成伤害或损坏产品。
- 拆解、改造或拆卸脚壳，或再次拆卸或改造产品构件会使质保失效。

一般说明

安装

只能使用优质近端内骨骼构件 (30 mm)。免维护 Accent 假足永久装配在脚壳上。对于 DP 安装，请参阅“切割动态塔架和 DP 套筒接头技术贴士”指导。

脚跟高度调节按钮

脚跟高度调节按钮可位于脚踝中间或侧边。除非客户另有规定，否则 Accent 假足出厂时采用中间按钮布置。

脚跟高度调节

1 若要调节脚跟高度，应按住脚跟调节按钮。

2 脚跟达到所需高度之后，放开脚跟高度调节按钮并锁定。站立，并在脚跟上稍稍用力，确认机构稳定落座。

静态校准

为发挥最佳功能，应恰当设置负载线，在 1/3 脚跟至 2/3 脚趾处将假足一分为二。
为了充分发挥 2"(51 mm) 脚跟高度调节的好处，在初始校准时应使假足处于背屈程度最大的位置。为此，应将其设在所需的最低脚跟高度位置（鞋或裸足），以便在需要较高脚跟高度时能够进行最大范围的调整。我们还建议对多只鞋和多个脚跟高度的理想校准情况和功能进行检查。

动态调节

预期效果	校准方式变更
更紧致的脚趾反应	使 Accent 产生跖屈，或向后移动负载线
更松弛的脚趾反应	使 Accent 产生背屈，或向前移动负载线
更紧致的脚跟反应	使 Accent 产生背屈，或向前移动负载线
更松弛的脚跟反应	使 Accent 产生跖屈，或向后移动负载线

美观

动态塔架 (DP) 和一体式塔架 (IP) 选件都需要采用护踝罩，以使表面光滑过渡，获得美化外观和避免受到环境因素影响。为完成组装，请参阅《Accent 护踝罩/美化外观说明书》（随附护踝罩产品提供）。

GAIT MATCHING® 操作指南

若对变更步态匹配有任何问题，请联系 College Park 技术服务人员。